


# Praktische Entwicklung von Medizinprodukten


von  
Prof. Peter P. Pott

am


31.07.2020

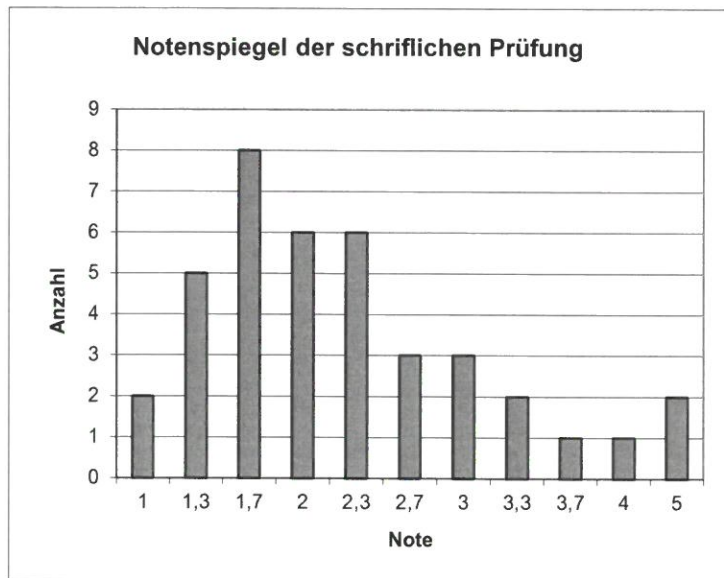

Durchschnitt 2,29

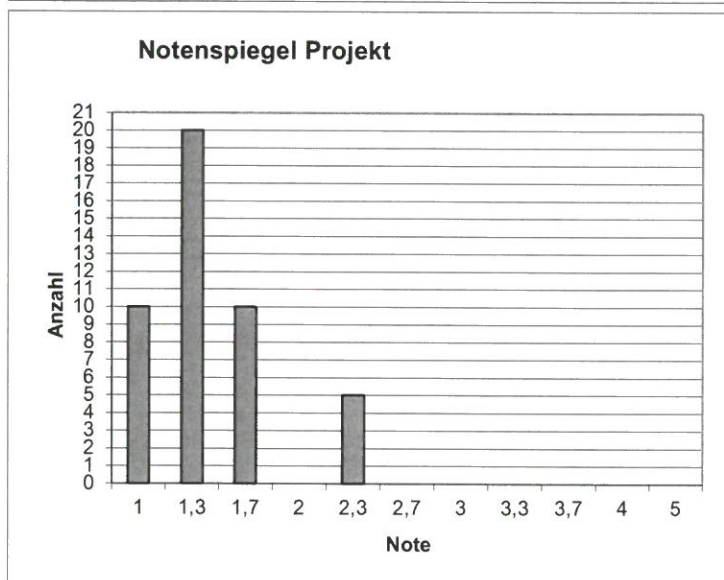

Durchschnitt 1,43

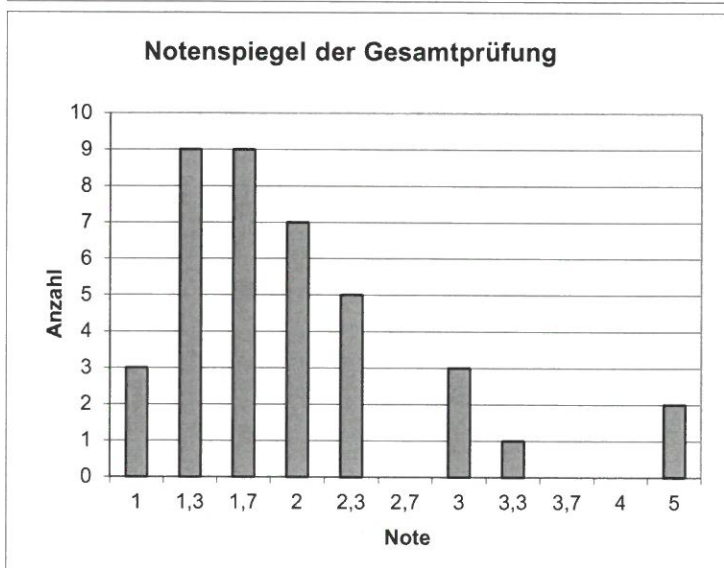

Durchschnitt 1,99

Universität Stuttgart  
Institut für  
Medizingerätetechnik  
Prof. Dr. Peter P. Pott  
Pfaffenwaldring 9, 70569 Stuttgart

03. Sep. 2020